



Standort Defibrillator Dorfschulhaus

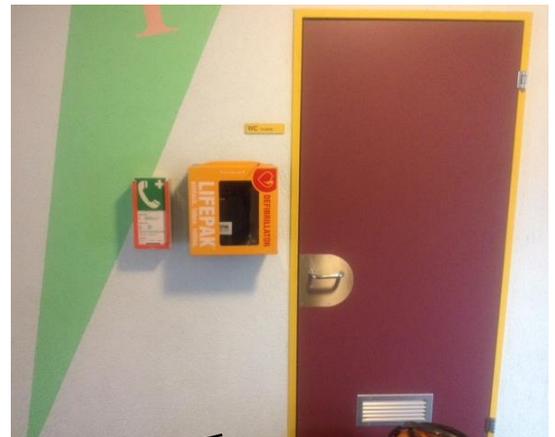

WC Invalide

1. Plombe durch abziehen nach oben entfernen.

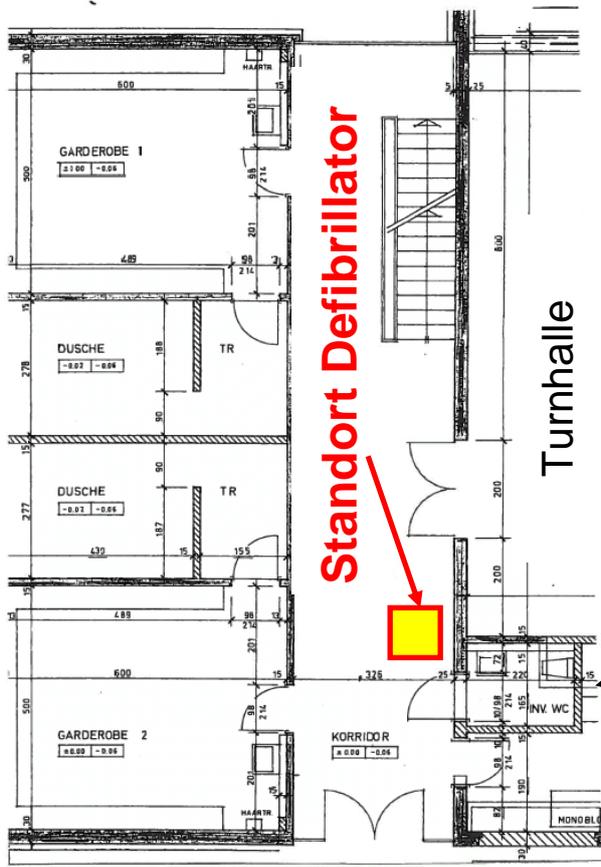

2. Den Griff gegen sich ziehen und öffnen. Der Kasten ist alarmüberwacht. Nach dem Öffnen bitte wieder schliessen.

